

# LUMEX<sup>®</sup>

by graham-field

## Imperial Collection Commode

*Colección Imperial de Inodoro*

Items 6438A, 7446A-2



graham  
field

QTY. 1 EA

## SAFETY GUIDELINES - PLEASE READ BEFORE USE

- **DO NOT** use this product without first completely reading and understanding these instructions and any additional instructional material such as owner's manuals, service manuals or instruction sheets supplied with this product. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment - otherwise, injury or damage may occur.
- Users with limited physical capabilities should be supervised or assisted when using the commode.
- Item 6438A has a maximum weight capacity of 600 lb.  
EVENLY DISTRIBUTED.  
Item 7446A-2 has a maximum weight capacity of 400 lb.  
EVENLY DISTRIBUTED.
- GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly, or use of this product.
- Leg extensions with rubber tips **MUST** be in contact with the floor at all times.
- Ensure that the push buttons fully protrude through the same height adjustment hole of each leg extension. This ensures that the leg extensions are securely locked in position and that an even height adjustment is achieved.
- Make sure that all attaching hardware, screws, nuts and/or bolts are tight at all times.
- Inspect rubber tips on the leg extensions for rips, tears, cracks or wear or if they are missing. Replace them **IMMEDIATELY** if any of these conditions exist.
- The commode seat **MUST** be installed before sitting on the commode.
- **DO NOT** place weight on front of arm; doing so could cause the arm to drop unexpectedly. Place weight vertically on armrest **ONLY** (see figure 1).
- If components are damaged or missing, contact your GF Health Products, Inc. distributor immediately.

 **WARNING: Cancer and Reproductive Harm-**  
[www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov).

## MAINTENANCE

- Use a mild soap and water solution, rinse with clear water, then dry with a soft cloth. Ensure that product is well rinsed before using.
- Never use organic solvents, abrasive cleaners, or scouring pads on any part of the product.
- Check fit and tightness of all nuts, bolts and knobs weekly to ensure that product is safe to use.
- To guarantee the best service from your product, always specify Lumex replacement parts, available from your GF Health Products, Inc. authorized distributor.

For more information regarding GF Health Products, Inc. products, parts and services, please contact your distributor or visit us online at [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com).

## SETUP

1. Remove frame, commode platform and back support from box. Unwrap all packaging materials.
2. Commode platform is already attached to frame, as shown below; ensure that all sides of platform are secured to frame.
3. The commode comes in its lowest position. Adjusting to desired height is recommended before use.

## ARM ADJUSTMENT (6438A ONLY)

- **Drop Armrest:** to drop the armrest, push the release lever inwards to release the armrest. This releases the armrest allowing for the transfer on and off the commode.
- **Raise Armrest:** to raise the armrest, lift the armrest to the upright position, ensuring that the push button protrudes fully from locking hole.

## ADJUSTING LEG HEIGHT

1. Depress the height adjustment button and slide the lower leg upward or downward until the height adjustment button is fully engaged in the desired hole.  
**NOTE:** *An audible “click” will be heard.*
2. Repeat for other 3 legs.  
**CAUTION:** *Ensure that all four commode legs are adjusted to the same height, and that all height adjustment buttons protrude fully through adjustment holes before use.*



Figure 1

## LIMITED WARRANTY

GF Health Products, Inc. ("GF") warrants this product to be free from defects in materials and workmanship to the original retail purchaser or original lessee only ("Customer") for:

**Frame:** five (5) years

**Tips, Wheels/Casters, and Handgrips:** three (3) months

The warranty does not cover: 1) other non-durable components; 2) defects, damage or other conditions caused by misuse, abuse, negligence, alteration, accident, freight damage, tampering or failure to seek and obtain repair or replacement in a timely manner; and 3) products not installed, used, or properly cleaned and maintained in accordance with the applicable GF instructions. Product provided to a lessee must be inspected prior to delivery and must be maintained by the Dealer. The lessee must be properly trained on the operation and safety of this product prior to use.

GF will, at its option, repair or replace the defective product. Warranty issues must: 1) be reported to the Dealer from whom the Customer purchased the product within the applicable warranty period and 2) upon examination by GF or its authorized representative, prove to be a warranty item. GF is not responsible for freight or labor charges associated with the warranted item. If there is no Dealer, you must contact GF directly by calling 770-368-4700, faxing 770-368-4932 or e-mailing [cs@grahamfield.com](mailto:cs@grahamfield.com). Specific directions will be provided.

TO THE GREATEST EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY IS GF'S ONLY WARRANTY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. EXCEPT IN CASES WHERE IMPLIED WARRANTIES MAY NOT BE VALIDLY WAIVED, GF MAKES NO IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. GF'S TOTAL LIABILITY FOR THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE COST OF THE PRODUCT(S) GIVING RISE TO THE CLAIM. IN NO EVENT WILL GF BE LIABLE FOR ANY DIRECT, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. CERTAIN LAWS MAY CONFER ADDITIONAL RIGHTS REGARDING WARRANTIES FOR SPECIFIC PRODUCTS AND IN THOSE INSTANCES GF'S LIABILITY AND THE LIABILITY OF GF'S SUPPLIERS, SHALL BE LIMITED TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights, which vary from state to state or country to country.

*For additional information related to warranty claims, please visit GF's terms and conditions located on [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)*

## GARANTIA LIMITADA

GF Health Products, Inc. ("GF") garantiza este producto de ser libre de defectos en material o calidad utilizado al comprador original o arrendatario (cualquiera es el "Cliente") solamente por:

**Marco:** cinco (5) años

**Ruedas, empuñaduras, frenos de mano, almohadillas de antebrazo, y**

**asiento:** tres (3) meses

La garantía no cubre: 1) otros componentes no durables; 2) defectos, daños u otras condiciones causadas, en su totalidad o en parte, por el mal uso, abuso, negligencia, alteración, accidentes, daños durante el transporte, manipulación indebida o dejar de solicitar y obtener la reparación o el reemplazo de una manera oportuna; 3) productos que no se instalen, utilicen, limpien y mantengan de manera apropiada, como se requiere en el manual de GF. Productos provistos a un arrendatario deben ser inspeccionados antes de entrega y deben ser mantenidos por el Distribuidor. El arrendatario o Cliente debe ser entrenado propiamente en la operación y seguridad de este producto antes de uso.

GF va a decidir, a su opción, reparar o reemplazar un producto defectivo. Cuestiones de garantía deben: 1) ser reportados al Distribuidor de donde el consumidor compró el producto dentro del período de garantía aplicable y 2) en examinación por GF o su representante autorizado, dar prueba del producto de garantía. GF no es responsable por flete o cargos de labor asociados con el producto bajo la garantía. Si no hay un Distribuidor, puede contactar a GF directamente llamando 770-368-4700, por fax 770-368-4932 o por email [cs@grahamfield.com](mailto:cs@grahamfield.com). Direcciones específicas serán suministradas.

A LA MEDIDA MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA GARANTÍA DE GF Y ES EN VEZ DE TODAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESADAS O IMPLÍCITAS. GF NO HACE GARANTÍAS ENTENDIDAS DE CUALQUIERA MANERA INCLUYENDO GARANTÍAS ENTENDIDAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PREPÓSITO PARTICULAR. SI UN MODELO Y MUESTRA SE LE ENSEÑA A UN CLIENTE, TAL MODELO O MUESTRA FUE UTILIZADO SOLAMENTE PARA ILUSTRAR EL TIPO GENERAL Y CALIDAD DEL PRODUCTO Y NO PARA REPRESENTAR QUE EL PRODUCTO SE CONFORME CON ESE MODELO Y MUESTRA EN TODOS RESPECTOS. TODA RESPONSABILIDAD DE GF POR CUALQUIER PRODUCTO ES LIMITADA AL COSTO DEL PRODUCTO EN LA RECLAMACIÓN. EN NO EVENTO EN CONTRATO, INDEMNIZACIÓN, GARANTÍA, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O OTRO QUE GF SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO, ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL, EJEMPLAR O CONSIGUIENTES. ALGUNAS LEYES PUEDEN CONFERIR DERECHOS ADICIONALES SOBRE GARANTÍAS Y EN ESOS INSTANTES LA RESPONSABILIDAD DE GF Y LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES DE GF SERÁN LIMITADAS A LA MEDIDA MÁXIMO PERMITIDA POR LA LEY. Esta garantía le provee derechos legales específicos. Usted podrá tener otros derechos, que se varían por estado a estado o país a país.

*Por información adicional sobre reclamaciones de garantía, por favor de visitar los términos y condiciones de GF que se encuentran en la página [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)*

## DIRECTRIZ DE SEGURIDAD – POR FAVOR DE LEER ANTES DE USO

- **NO DEBE UTILIZAR** este producto sin primero leer y entender estas instrucciones y cual quiere otro material como el manual de usuario, manual de servicio hoja de instrucción suministrado con este producto. Si no puedes entender las advertencias, cauciones o instrucciones, llame a su profesional de cuidado de salud, distribuidor o personal técnica antes de tratar de usar este equipo – o si no, herida o daño puede ocurrir.
- Usuarios con capacidades físicas puede ser supervisados o asistidos cuando utilizar el inodoro.
- 6438A – Capacidad de peso máximo de 600 lb  
DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE  
7446A-2 – Capacidad de peso máximo de 400 lb  
DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE
- GF Health Products, Inc. no asume ninguna responsabilidad por daño o herida causado por instalación, ensamblaje o uso impropio de este producto.
- Extensiones de patas con puntas de goma **TIENEN** que estar en contacto con el piso todo el tiempo.
- Asegure que los botones de apretar sobresalen completamente por los mismos huecos de ajustamiento de altura de cada extensión de pata. Esto asegura que las extensiones de pata están asegurados en posición y que el ajustamiento de altura esta uniforme.
- Asegure que la ferretería, tornillos y perillos están apretados todo el tiempo.
- Examine las puntas de goma en las extensiones de patas para grietas o desgaste o si faltan. Reemplace **INMEDIAMENTE** si estas condiciones existen.
- El asiento del inodoro **TIENEN** que estar instalado antes de sentarse en el inodoro.
- **NO** coloque el peso en la parte delantera del brazo; hacerlo podría provocar que el brazo caiga de forma inesperada. Coloque el peso verticalmente en el apoyabrazos **SOLAMENTE** (véase la figura 1)
- Si los componentes están dañados o si faltan, llame a su distribuidor de GF Health Products, Inc. inmediatamente.



## MANTENIMIENTO

- Utilice una solución de jabón suave y agua, enjuague con agua limpia y seca con una toalla suave. Asegure que el inodoro esta enjuagado bien antes de uso.
- Nunca utilice solventes orgánicos, limpiadores abrasivos en cual quiere parte de este inodoro.
- Cheque seminalmente que los tornillos y perillas están apretados para asegurar que el inodoro esta bueno para utilizar.
- Para garantizar el servicio mejor de su inodoro, siempre pide partes de reemplazo de Lumex si son disponible por su distribuidor de GF Health Products, Inc.

Para mas información sobre su producto, partes o servicio de GF Health Products, Inc, por favor de llamar a su distribuidor o visítenos online en [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com).

## MONTAJE

1. Saque el marco, el plataforma del inodoro y el soporte de espalda del cartón. Desenvuelve todo los materiales de empaque.
2. Plataforma del inodoro viene ajunto al marco, como demostrado abajo; asegure que todos los lados del plataforma son asegurados al marco.
3. El inodoro viene en su posición mas baja. Ajustando la altura deseado es recommendado antes de uso.

## AJUSTAMIENTO DE APOYABRAZO (SOLAMENTE PARA 6438A)

- **Bajar Apoyabrazo:** para bajar el apoyabrazo empuje la palanca hacia adentro para soltar el apoyabrazo. Esto suelta el apoyabrazo para permitir transferir sobre y fuera del inodoro.
- **Subir Apoyabrazo:** para subir el apoyabrazo, levanta el apoyabrazo en su posición vertical, asegurando que el botón de apretar sobresale completamente por el hueco.

## AJUSTANDO LA ALTURA DEL INODORO

1. Apriete el botón de ajustamiento de altura y deslice la parta inferior de la pata hacia arriba y abajo hasta que el botón de ajustamiento esta asegurado en el hueco deseado  
**Nota:** *Se oye un “clic” cuando esta puesto.*
2. Repita para las otras 3 patas.  
**CAUCION:** *Asegure que todas cuatros patas están ajustados a la misma altura y que todos los botones de ajustamiento sobresalen por los huecos de ajustamiento antes de uso.*

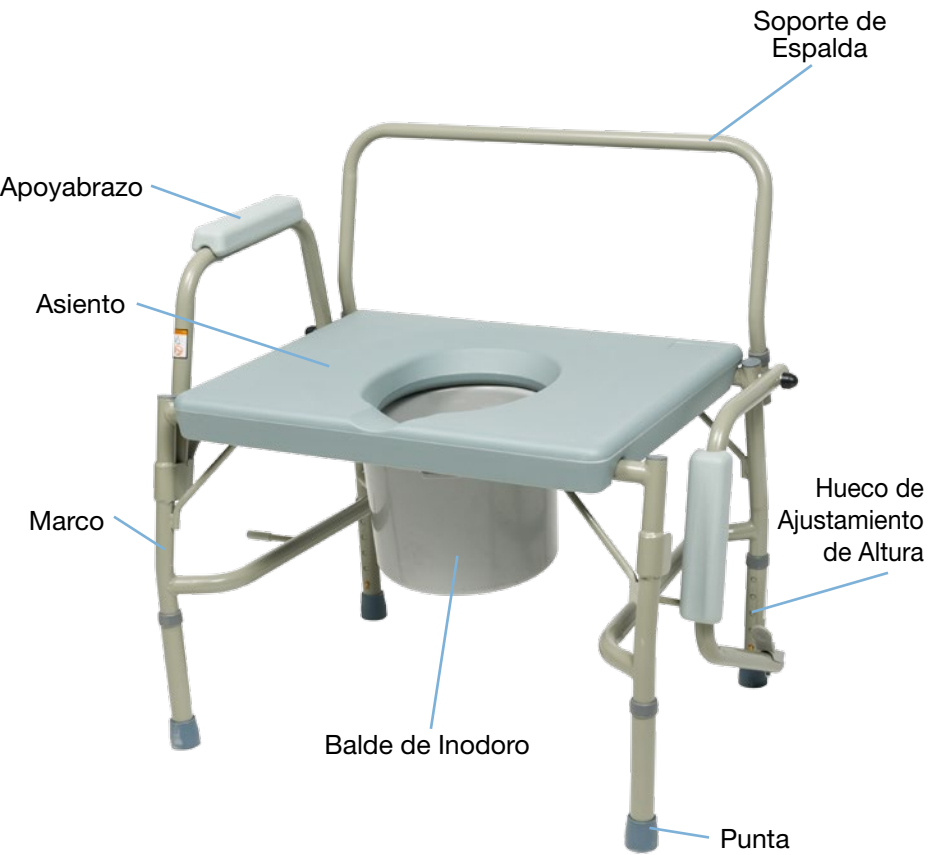


Figura 1

## Features

- Arms drop independently below seat level for lateral transfers (6438A only)
- Arms automatically lock in raised position
- Extra wide platform seat is comfortable for long periods of sitting
- Welded steel construction and extra wide base provide added stability
- Cushioned armrests enhance user comfort
- Comes complete with commode pail, cover and splash guard
- Removable back bar facilitates use as a bedside commode, raised toilet seat or toilet safety frame
- 6438A – 600lb maximum weight capacity EVENLY DISTRIBUTED
- 7446A-2 – 400lb maximum weight capacity EVENLY DISTRIBUTED
- Designed to meet the requirements of HCPCS code: E0168

## Características

- Apoyabrazos se bajan independiente abajo del nivel del asiento para transferir lateral con seguridad (solamente 6438A)
- Apoyabrazos se cierran automáticamente en la posición subida
- Asiento plataforma mas ancho es comfortable para sentarse por periodos largos
- Construcción de acero aumenta esfuerzo y estabilidad
- Apoyabrazos acolchonados aumentan comodidad de usuario
- Viene completa con el balde de inodoro, tapa y salpicadera
- Respaldo desmontable facilita uso como inodoro al lado de cama, asiento elevado o marco de inodoro para seguridad.
- 6438A – Capacidad de peso máximo de 600 lb  
DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE
- 7446A-2 – Capacidad de peso máximo de 400 lb  
DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE
- Diseñado a reunir los requisitos de código de HCPCS: E0168

For the most updated and current information on packaging, warranties, products and specifications, please visit our website at [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)

Para la información más ultimo sobre embalaje, garantías, productos y especificaciones, por favor de visitar a nuestro sitio de internet a [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)

© 2009, GF Health Products, Inc.,  
One Graham-Field Way, Atlanta, Georgia 30340.  
Made in China. [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)